PARAMOUNT BED

取扱説明書

7F07354500A0

KQ-P90C

保証書付

キャスター（在宅ケアベッド楽匠 S シリーズ専用）

まえがき

このたびは、**キャスター**をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この「取扱説明書」には、**キャスター**を安全にお使いいただくための注意事項や使用方法などを記載しています。

●キャスターをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」および楽匠 S シリーズの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。

●ベッドで療養する方ばかりでなく、介護する方もこの「取扱説明書」および楽匠 S シリーズの「取扱説明書」をよくお読みください。

●この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。

●お買い上げの製品は改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。

●ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合せください。

使用目的

■この製品はベッドに取付けることにより、部屋の中での配置換えや掃除をする際などに、ベッドの移動を補助することを目的に作られています。

※長い距離や段差・傾斜のあるゆか面などでの移動には適していません。

各部の名称
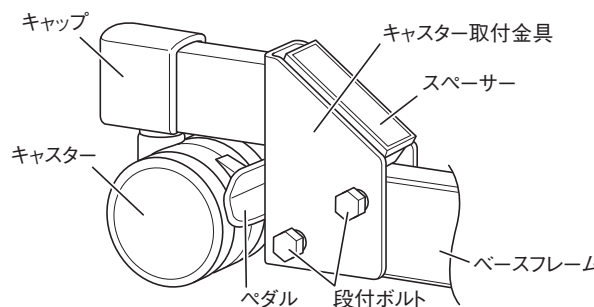
開梱と部品の確認

■開梱後、下記の部品がすべて揃っていること、破損していないことを確認してください。万一、部品の不足や破損があった場合には、販売店または直接弊社までご連絡ください。

パラマウントベッド株式会社
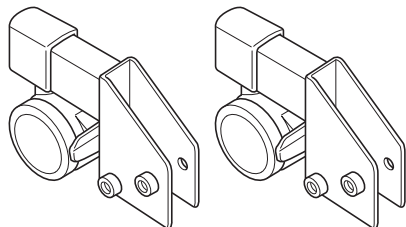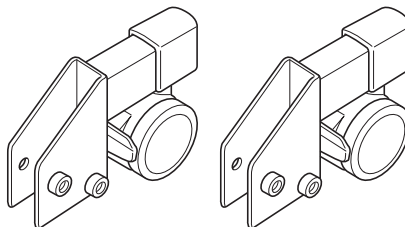
安全に使用するための注意事項

⚠ 警告（けいこく）	この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷（骨折･圧迫･麻痺（まひ）など）を負う可能性が想定される内容を示しています。

■ベッドを移動させるとき以外は４ヶ所のキャスターすべてを固定状態にしてください

●ベッドに乗り降りする際などに、ベッドが動いて思わぬけがをするおそれがあります。

■お客様による修理・改造はしないでください

●思わぬけがや故障の原因となります。

■弊社が指定する適合品以外の製品とは組合せないでください

●キャスターと組合せて使用するベッドは、必ず楽匠Ｓシリーズ（KQ-9***）を使用してください。指定以外の製品と組合せると、思わぬけがや故障の原因となります。

注意（ちゅうい）	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷（打撲・すり傷・切り傷など）を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■長い距離や段差・傾斜のあるゆか面などでの移動は避けてください

●長い距離を移動させると、ベッドやキャスターの故障の原因となります。

●ベッドの部品とゆかとのすきまが少ないため、ゆかを傷つけることがあります。また、ベッドやキャスターの故障の原因となるおそれがあります。

※ベッドの部品とゆかとのすきま：約 1cm

■以下の場合にはキャスターの下に敷物（脚座カーペット：別売など）を敷いてください

●畳やじゅうたんなどの上で長期間使用する場合、ゆか材がへこむおそれがあります。

●ビニル系のゆか材の上で使用する場合、ゆか材が変色するおそれがあります。

■スプレータイプの殺虫剤をキャスターに直接噴射しないでください

●殺虫剤に含まれる溶剤によってキャスターが破損・変色などするおそれがあります。また、破損した部分で思わぬけがをするおそれがあります。

■キャスターとキャスター取付金具のすき間やベースフレームとゆかとのすき間に、足先や手や指などをはさまないように注意してください

●キャスターが旋回したときや移動させる際に、すき間にはさまれて、けがをするおそれがあります。
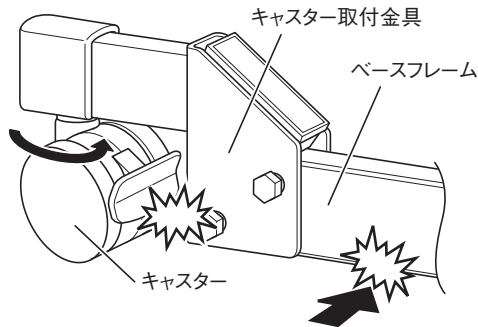
仕様

品　　名			キャスター
品　　番			KQ-P90C
キャスター色			ダークグレー
主要寸法	キャスター		キャスター径：φ 65mm ／キャスター幅：62mm
	キャスター取付金具		長さ 153mm ×幅 42mm ×高さ 102mm
製品質量（１個当り）			キャスター：約 280g ／キャップ：約 40g ／キャスター取付金具：約 490g
材質	キャスター	車輪	熱可塑性エラストマー
		ペダル	ナイロン
		軸	スチール
	キャスター取付金具		スチール
	キャップ		ナイロン
	スペーサー		ポリプロピレン
	段付ボルト		スチール
適合品			楽匠Ｓシリーズ（KQ-9*** シリーズ）

使用方法

ベッドを移動させるとき	ベッドを移動させるとき以外
4輪すべての固定状態を解除してください	4輪すべてを固定状態にしてください
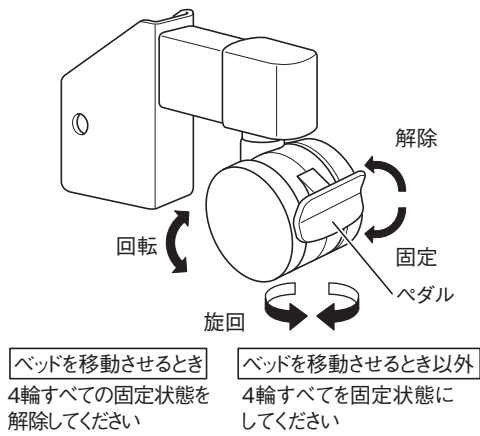
❶ペダルを下側にすると回転・旋回ともに固定された状態になります。固定状態にするとキャスターは回転・旋回しません。

❷ペダルを上側にすると回転・旋回ともに固定状態が解除されます。固定状態を解除するとキャスターは回転・旋回します。

●固定状態にすると、キャスターが回転・旋回しないことを確認してください。

●固定状態を解除すると、キャスターがスムーズに回転・旋回することを確認してください。

●ベッドを移動させるとき以外は、4ヶ所のキャスターすべてを固定状態にしてください。ベッドに乗り降りする際などに、ベッドが動いて思わぬけがをするおそれがあります。

●キャスターが固定された状態でベッドを無理に動かさないでください。ベッドやキャスターが故障したり、ゆか材を傷つけるおそれがあります。

適合品

■楽匠Sシリーズ（KQ-9***）専用です。

■楽匠Sシリーズとこのキャスターの組合せはJIS認証を取得しています。

取付方法

●組立てられているベッドにキャスターを取付けるときは、ベッドを分解してベースフレームのみの状態にし、ベースフレームの脚座を取外してから作業を行ってください。（ベッドの分解方法は、ベッド本体の「取扱説明書」中の「ベッドの分解方法」を参照してください。）
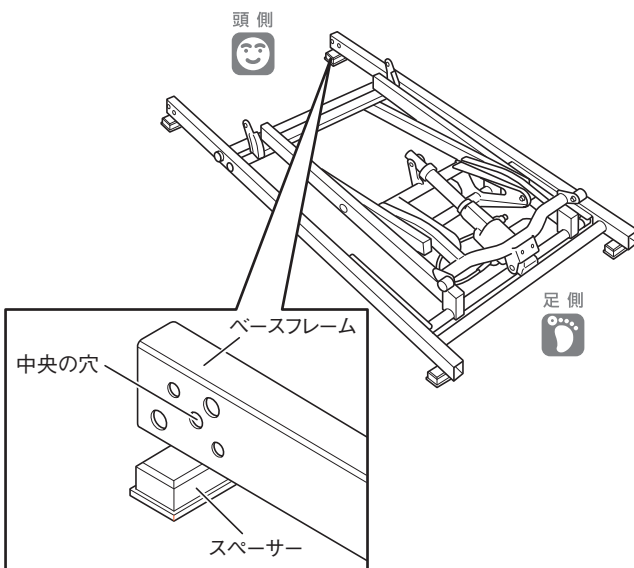
1．スペーサーの設置

❶ベースフレームを少し持ちあげ、ベースフレームの下にスペーサーを入れてください。（4ヶ所）

●ベースフレームの中央の穴の真下にスペーサーを入れると、以降の作業がしやすくなります。
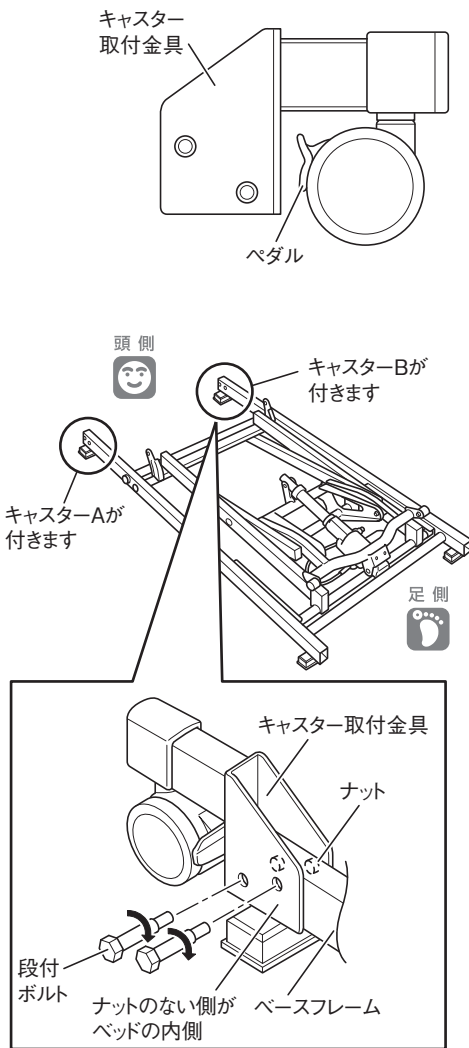
●スペーサーを入れる際、手や指などをはさまないように注意してください。けがをするおそれがあります。

取付方法

2. キャスターの固定

❶図のように、ペダルをキャスター取付金具に向けた状態で、４個すべてのキャスターを固定状態にしてください。

●キャスターが固定状態になっていない場合、組立作業中にベッドが動いて思わぬけがをするおそれがあります。

3. 頭側のキャスターの取付け

●先に頭側（２ヶ所）のキャスターを取付けてください。足側（２ヶ所）はベースフレームと足側フレームを組立てた後で取付けます。

※足側（２ヶ所）のキャスターを先に取付けてしまうと、ベースフレームと足側フレームの組立てができなくなります。

❶ナットがない側をベッドの内側にして、キャスター取付金具をベースフレームのパイプにかぶせてください。（頭側の左右各1ヶ所）

●キャスターには向きがあります。左図を参照してキャスターＡ・Ｂの取付け向きに注意してください。

❷段付ボルトをベッドの内側から差込んで仮止めし、付属のスパナで締付けてください。（頭側の左右各２ヶ所）

●段付ボルトは適正な状態まで締付けてください。段付ボルトがゆるんでいると、キャスターががたついたり外れてけがをするおそれがあります。段付ボルトを締付ける際、ボルトの頭とキャスター取付金具との間にすき間（右図参照）ができるのが適正な状態です。段付ボルトを締付けすぎないように注意してください。

❸キャスター取付金具にゆるみやがたつきがないことを確認してください。

4. 足側フレームの取付け

❶ベッド本体の「取扱説明書」中の「ベッドの組立方法」に従って、ベースフレームと足側フレームを組立ててください。

●組立てる際に、スペーサーからベースフレームが落ちないように注意してください。思わぬけがをしたり、ゆか材を傷つけるおそれがあります。
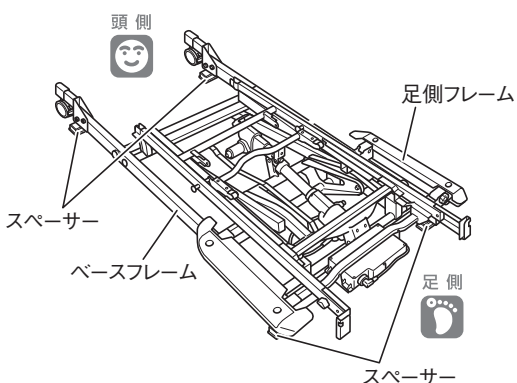
取付方法
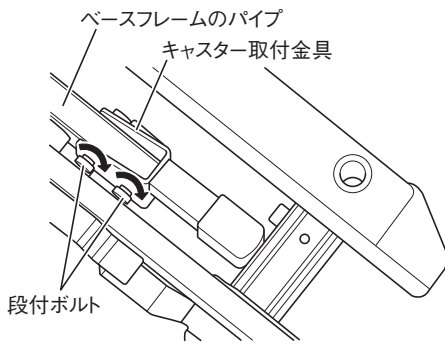
5. 足側のキャスターの取付け

❶ナットがない側をベッドの内側にして、キャスター取付金具をベースフレームのパイプにかぶせてください。（足側の左右各１ヶ所）
❷段付ボルトをベッド内側から差込んで仮止めし、付属のスパナで締付けてください。（足側の左右各２ヶ所）
❸キャスター取付金具にゆるみやがたつきがないことを確認してください。

●足側のキャスターの取付方法は頭側と同じです。キャスターの向き・段付ボルトの締付けに関する警告・注記は「3. 頭側のキャスターの取付け」を参照してください。

6. スペーサーの取付け

❶ベッドを少し持ちあげて、ベースフレームの下に入れたスペーサーを外し、キャスターを接地させてください。（4ヶ所）

●スペーサーを外す際、手や指などをはさまないように注意してください。けがをするおそれがあります。

❷❶で外したスペーサーを、キャスター取付金具の開口部に取付けてください。（4ヶ所）
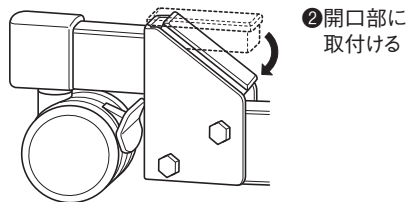
●図のように、スペーサーの端部を先に挿入すると取付けやすくなります。

●キャスター取付金具の開口部にスペーサーを必ず取付けてください。開口部で思わぬけがをするおそれがあります。
●スペーサーを取付ける際、手や指などをはさまないように注意してください。けがをするおそれがあります。

※以降のベッドの組立方法については、ベッド本体の「取扱説明書」を参照してください。

取外方法
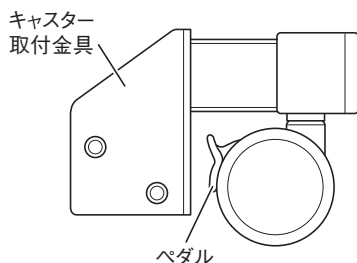
1. キャスターの固定

❶図のように、ペダルをキャスター取付金具に向けた状態で、4個すべてのキャスターを固定状態にしてください。

●キャスターが固定状態になっていない場合、取外し作業中にベッドが動いて思わぬけがをするおそれがあります。

2. ベッドの分解

❶ベッドを分解し、足側フレームとベースフレームの状態にしてください。（ベッドの分解方法は、ベッド本体の「取扱説明書」中の「ベッドの分解方法」を参照してください。

●ベッドを分解せずにキャスターを取外すと思わぬけがをしたり、ベッドが破損・変形するおそれがあります。

取外方法
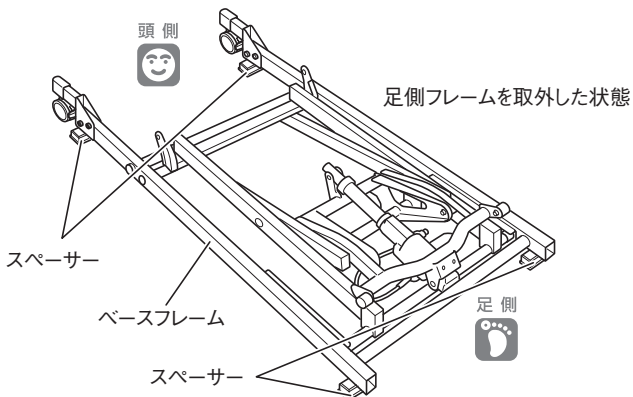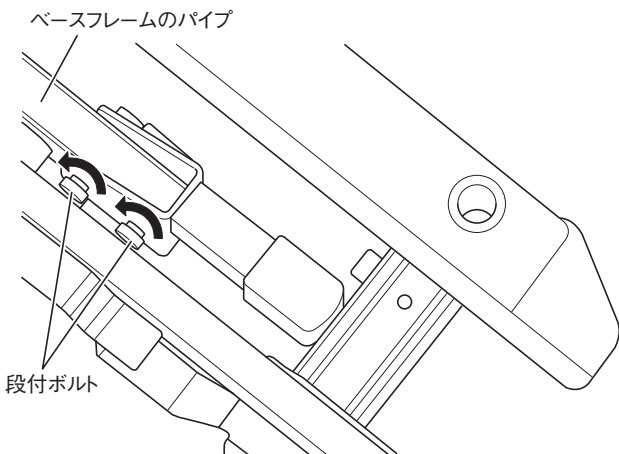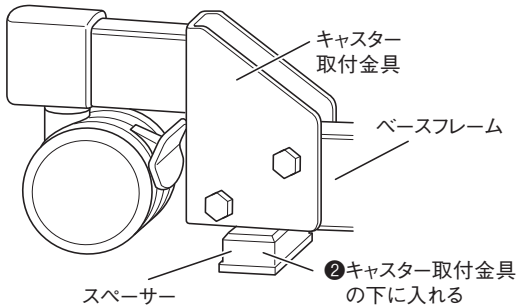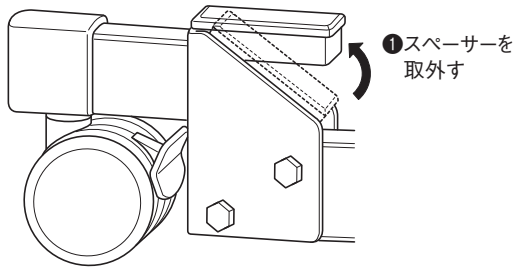
3．スペーサーの取外しと設置

❶キャスター取付金具の開口部に取付けられているスペーサーをドライバーなどを使用して取外してください。（4ヶ所）

●取外す際に、部品を傷つけないように注意してください

❷ベースフレームを少し持ちあげ、ベースフレームの下にスペーサーを入れてください。（4ヶ所）

●キャスター取付金具の真下部分に入れると以降の作業がしやすくなります。

●スペーサーを入れる際、手や指などをはさまないように注意してください。けがをするおそれがあります。

4．足側のキャスターの取外し

❶キャスターを固定している段付ボルトを取外してください。（足側の左右各２ヶ所）

❷ベースフレームからキャスターを取外してください。（足側の左右各1ヶ所）

●足側のキャスターを取外さないと、足側フレームを取外すことができません。

5．足側フレームの取外し

❶ベッド本体の「取扱説明書」中の「ベッドの分解方法」に従って、足側フレームを取外してください。

●取外す際に、スペーサーからベースフレームが落ちないように注意してください。思わぬけがをしたり、ゆか材を傷つけるおそれがあります。

取外方法
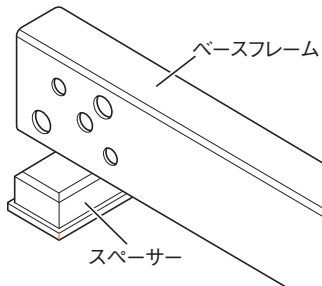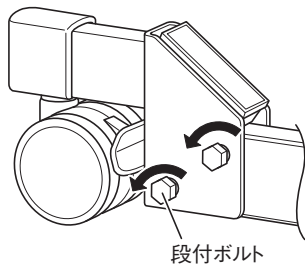
6. 頭側のキャスターの取外し

❶キャスターを固定している段付ボルトを取外してください。（頭側の左右2ヶ所）
❷ベースフレームからキャスターを取外してください。（頭側の左右各1ヶ所）

7. スペーサーの取外し

❶ベースフレームを少し持ちあげ、ベースフレームの下からスペーサーを取外してください。（４ヶ所）

●スペーサーを取外す際、手や指などをはさまないように注意してください。けがをするおそれがあります。

お手入れ・長期保管について

■日常のお手入れ

●清拭する場合は、水で薄めた中性洗剤にひたした布をよくしぼって拭き、その後水でひたした布をよくしぼって、残った洗剤分を拭き取ってください。最後に乾いた布で拭き取ってください。

※揮発性のもの（シンナー、ベンジン、ガソリンなど）やクレゾールは使用しないでください。変色・変質させるおそれがあります。

●消毒剤を使用する場合は必ず下記の薬品を指定の濃度でご使用ください。

0.05 ～ 0.2%　塩化ベンザルコニウム（オスバンなど）
0.05 ～ 0.2%　塩化ベンゼトニウム（ハイアミンなど）
0.05%　グルコン酸クロルヘキシジン（ヒビテンなど）
0.02 ～ 0.05% 次亜塩素酸ナトリウム（ミルトンなど）

●洗剤、消毒剤で清拭した場合は、その後、水拭きをしてください。水拭きをしないと樹脂の部分が割れるおそれがあります。

●オゾン殺菌器、オートクレーブ滅菌器などには対応できません。

●キャスターへの注油や分解によるキャスター内部の清掃はしないでください。

■長期保管する場合

●高温・多湿・低温・乾燥・ほこりの多い場所を避けてください。
温度 -10 ～ 50℃、湿度 30 ～ 90%ＲＨの環境で保管してください。

■付属品の保管

●本取扱説明書および組立付属部品を袋などに入れて保管してください。

キャスターの交換について

■キャスターは消耗部品のため、長期間ご使用頂いた場合、摩耗、損傷などにより機能が低下するおそれがあります。下記の場合、キャスター、キャップおよびスペーサーを交換してください。

●ベースフレームを持ちあげたときにキャスターがキャップから抜ける場合。
●キャスターのペダルを下側にしても、回転・旋回が固定状態にならない場合。
●車輪の劣化により、４ヶ所のキャスターすべてを固定状態にしてもベッドが動いてしまう場合。
●スペーサーがキャスター取付金具から簡単に外れてしまう場合。

アフターサービスについて

1. 保証書

保証書は、必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、記載内容をよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より１年間です。

２. 修理を依頼されるとき

修理のご依頼は、お買い上げの販売店または弊社製品の修理受付窓口であるパラテクノコールセンター（下記参照）までご連絡ください。

■連絡していただきたい内容

●品名、品番（下記保証書を参照）
●お買い上げ日
●破損または異常の内容（できるだけ詳しく）
●お名前、ご住所および電話番号

■保証期間内は

保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。ただし、保証期間内でも修理が有償になる場合があります。詳しくは下記の保証書をご覧ください。

■保証期間が過ぎているときは

修理により使用できる製品については、ご要望により有償で修理いたします。

3. 部品の最低保有年数は

弊社では、この製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間を製造打ち切り後８年としております。

4. アフターサービスについてご不明な場合

お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合せください。

パラテクノコールセンター　☎ 0120-54-8639

受付時間：平日９：00 ～ 17：20（土・日・祝日・夏季休業・年末年始休業を除く）

【パラテクノ株式会社について】

弊社製品の修理や保守点検などの各種サービスを実施する、弊社 100%出資の会社です。

保　証　書

品名／品番　キャスター／KQ-P90C		保証期間	★お買上げ日　年　月　日より１年間
お客様	お名前	★販売店	
	〒　☎（　） ご住所		☎（　）

★印欄の情報が確認できない場合は無効となりますので必ずご確認ください。
この保証書は、本書の記載内容に基づき無償修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、ラベル類などの注意書きに従った正しい使用状態で故障した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

【保証規定】

1. 保証期間内（お買い上げの日より１年間）に、正常なご使用状態において故障した場合は、無償で修理いたします。
2. 次のような場合は、保証期間内でも修理は有償となります。
（1）使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障および損傷
（2）弊社が指定する適合品以外の製品と組合せて使用したことによる故障および損傷
（3）お買い上げ後の移動、設置、落下あるいは輸送による故障および損傷
（4）火災、煙害、異常電圧および地震、雷、風水害、その他、天災地変などによる故障および損傷
（5）保証書のご提示がない場合
（6）本保証書の保証期間および販売店名の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合
3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
● This warranty is valid only in Japan.
4. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

< パラマウントベッド株式会社 >

本　社　〒136-8670　東京都江東区東砂２丁目14番５号 東京営業部　☎(03)3648-1171(代)
札幌支店　〒060-0062　札幌市中央区南２条西13丁目318番地11　☎(011)271-1181(代)
仙台支店　〒984-0015　仙台市若林区卸町２丁目３番地の３　☎(022)239-5211(代)
さいたま支店　〒338-0001　さいたま市中央区上落合９丁目４番７号　☎(048)852-0707(代)
横浜支店　〒194-0004　東京都町田市鶴間1715番地1　☎(042)795-8800(代)
名古屋支店　〒461-0001　名古屋市東区泉１丁目20番17号　☎(052)963-0600(代)
大阪支店　〒550-0001　大阪市西区土佐堀２丁目３番33号　☎(06)6443-8791(代)
広島支店　〒733-0011　広島市西区横川町３丁目８番５号　☎(082)293-1311(代)
福岡支店　〒812-0013　福岡市博多区博多駅東３丁目14番20号　☎(092)461-1131(代)

’08.12
製版：株式会社 創英